


Sänka, Stänga av larmljud Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Om du vill sänka/ stänga av larmljudet går du in på följande flik i monitorläge.
Denna inställning återställs till standard vid start av ny patient.

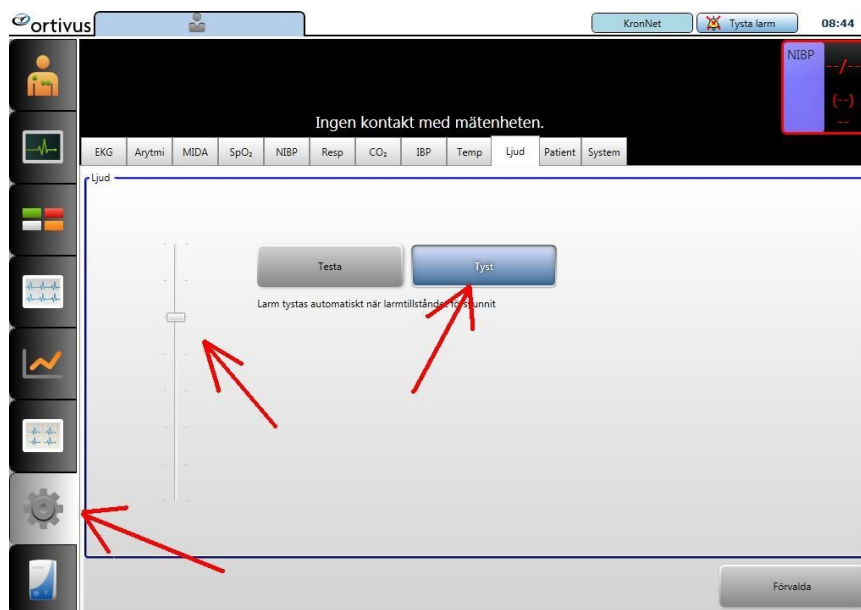

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare